



บริษัท เดนทัล ویژัน (ประเทศไทย) จำกัด  
Dental Vision (Thailand) Co., Ltd.

เลขที่ DVTSV6510-007


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558071884

เรื่อง เสนอราคาอะไหล่สำหรับ Dental Simulator ยี่ห้อ Saratoga

เรียน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(แผนก Simulation ที่กวนมราช ชั้น 10)

บริษัท ฯ มีความยินดีเสนอราคาสินค้าแก่ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
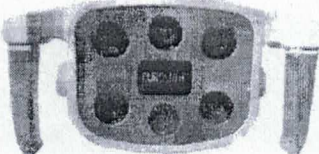
| ลำดับ           | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | ราคา/หน่วย | คิดเป็นเงิน |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|
| 1               | โคมไฟส่องปาก LED แบบ 6 ดวง พร้อมระบบเซ็นเซอร์ Dimmer และ<br>อะแดปเตอร์ข้อต่อโคมไฟและแขน<br>โต๊ะที่ 2/2 , 4/2 , 5/1 , 6/4 , 11/1 , 11/2 , 13/1<br><br>ส่วนลดค่าอะไหล่พิเศษ 10%<br>ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 3320007199 | 7 Set | 17,500.00  | 122,500.00  |
| ราคาก่อนรวมภาษี |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            | 103,037.38  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            | 7,212.62    |
| รวมเป็นเงิน     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            | 110,250.00  |

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

- หมายเหตุ: - ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว  
- กำหนดขึ้นราคาภายใน 30 วัน  
- กำหนดส่งของภายใน 90 วันหลังจากได้รับใบสั่งซื้อ  
- รับประกันคุณภาพ 90 วัน  
- ผู้จัดทำใบเสนอราคา นางสาวนันพร (จีบ) Tel.086-3408513  
- E-mail: nantaporn.k@dentalvision.co.th

สมชาย ใจดี  
T. 1105 45105

ขอแสดงความนับถือ

Anta (นาม)


(นายชัยภัทร์ อรรถประวิทย์)

ผู้จัดการแผนกช่าง

ผังห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

ชั้น 10

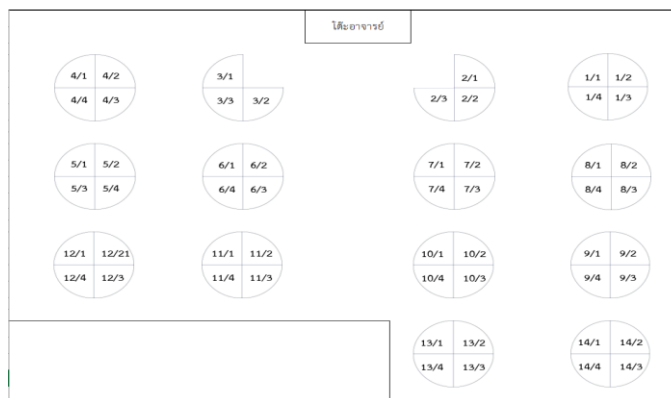

| โต๊ะที่ | SN/ เลขครุภัณฑ์ |                    | รายการที่เสีย |
|---------|-----------------|--------------------|---------------|
| อาจารย์ | SN:             |                    |               |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002539สล./56 |               |

| โต๊ะที่ | SN/ เลขครุภัณฑ์ |                     | รายการที่เสีย                                                    |
|---------|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1/1     | SN:             |                     | โคไฟชาร์ด + ขั้วชั้นหัวกรอชาร์ด + เซอร์รिनอยควบคุมนำหัวกรอ 2 ชุด |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002543สล./56  |                                                                  |
| 1/2     | SN:             |                     | เปลี่ยนชุดวาล์วควบคุม 3-way                                      |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002540 สล./56 |                                                                  |
| 1/3     | SN:             |                     | เปลี่ยนชุดวาล์วควบคุม 3-way                                      |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002542 สล./56 |                                                                  |
| 1/4     | SN:             |                     | เปลี่ยนชุดวาล์วควบคุม 3-way                                      |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002541 สล./56 |                                                                  |


| โต๊ะที่ | SN/ เลขครุภัณฑ์ |                     | รายการที่เสีย                                 |
|---------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| 2/1     | SN:             |                     | ก้านโยกสวิทซ์เท้าชาร์ด + ชุดวาล์วควบคุม 3-way |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002544 สล./56 |                                               |
| 2/2     | SN:             |                     | โคมไฟชาร์ด+ชุดวาล์วควบคุม 3-way               |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002545 สล./56 |                                               |
| 2/3     | SN:             |                     |                                               |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002546 สล./56 |                                               |

| โต๊ะที่ | SN/ เลขครุภัณฑ์ |                     | รายการที่เสีย                            |
|---------|-----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 3/1     | SN:             |                     | จอ TV ไม่ติด                             |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002549 สล./56 |                                          |
| 3/2     | SN:             |                     |                                          |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002547 สล./56 |                                          |
| 3/3     | SN:             |                     | ก้านโยกสวิทซ์เท้า + ชุดวาล์วควบคุม 3-way |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002548 สล./56 |                                          |

ผังห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมมวราช 80

ชั้น 10

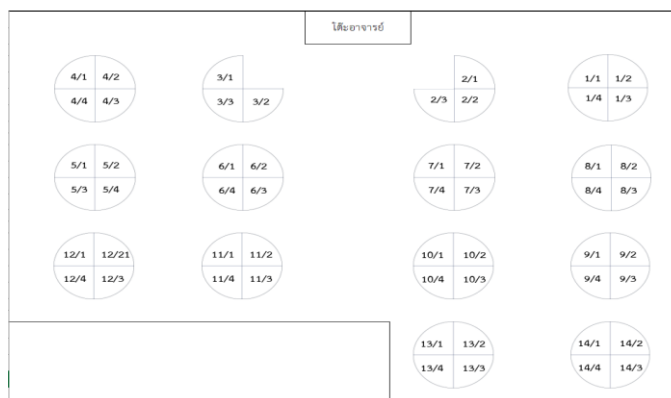

| โต๊ะที่ | SN/ เลขครุภัณฑ์ |                     | รายการที่เสีย    |
|---------|-----------------|---------------------|------------------|
| 4/1     | SN:             |                     |                  |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002553 สล./56 |                  |
| 4/2     | SN:             |                     | คอมพิวเตอร์ชำรุด |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002550 สล./56 |                  |
| 4/3     | SN:             |                     |                  |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002551 สล./56 |                  |
| 4/4     | SN:             |                     |                  |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002552 สล./56 |                  |


| โต๊ะที่ | SN/ เลขครุภัณฑ์ |                     | รายการที่เสีย                         |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|
| 5/1     | SN:             |                     | คอมพิวเตอร์ชำรุด + ปลาย 3-way ตัน     |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002557 สล./56 |                                       |
| 5/2     | SN:             |                     |                                       |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002554 สล./56 |                                       |
| 5/3     | SN:             |                     |                                       |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002555 สล./56 |                                       |
| 5/4     | SN:             |                     | จอ TV ไม่ติด + ก้านโยกสวิตช์เท้าชำรุด |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002556 สล./56 |                                       |

| โต๊ะที่ | SN/ เลขครุภัณฑ์ |                     | รายการที่เสีย                         |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|
| 6/1     | SN:             |                     |                                       |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002561 สล./56 |                                       |
| 6/2     | SN:             |                     | จอ TV ไม่ติด + ก้านโยกสวิตช์เท้าชำรุด |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002558 สล./56 |                                       |
| 6/3     | SN:             |                     |                                       |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002559 สล./56 |                                       |
| 6/4     | SN:             |                     | จอ TV ไม่ติด + คอมพิวเตอร์ชำรุด       |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002560 สล./56 |                                       |

ผังห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

ชั้น 10

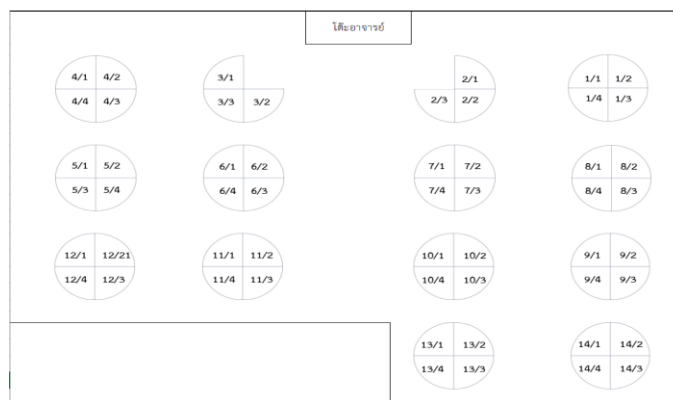

| โต๊ะที่ | SN/ เลขครุภัณฑ์ |                     | รายการที่เสีย                             |
|---------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 7/1     | SN:             |                     | จอ TV ไม่ติด + ขวดน้ำรั่ว                 |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002565 สล./56 |                                           |
| 7/2     | SN:             |                     | ก้านโยกสวิตซ์เท้าชำรุด                    |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002562 สล./56 |                                           |
| 7/3     | SN:             |                     | จอ TV ไม่ติด+ เปลี่ยนชุดวาล์วควบคุม 3-way |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002563 สล./56 |                                           |
| 7/4     | SN:             |                     | ก้านโยกสวิตซ์เท้าชำรุด                    |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002564 สล./56 |                                           |


| โต๊ะที่ | SN/ เลขครุภัณฑ์ |                     | รายการที่เสีย |
|---------|-----------------|---------------------|---------------|
| 8/1     | SN:             |                     | จอ TV ไม่ติด- |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002568 สล./56 |               |
| 8/2     | SN:             |                     | ขวดน้ำชำรุด   |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002566 สล./56 |               |
| 8/3     | SN:             |                     | จอ TV ไม่ติด- |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132280001971 สล./57 |               |
| 8/4     | SN:             |                     |               |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132200002567 สล./56 |               |

| โต๊ะที่ | SN/ เลขครุภัณฑ์ |                     | รายการที่เสีย |
|---------|-----------------|---------------------|---------------|
| 9/1     | SN:             |                     | จอ TV ไม่ติด- |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132280001975 สล./57 |               |
| 9/2     | SN:             |                     |               |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132280001972 สล./57 |               |
| 9/3     | SN:             |                     | จอ TV ไม่ติด- |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132280001973 สล./57 |               |
| 9/4     | SN:             |                     | จอ TV ไม่ติด- |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132280001974 สล./57 |               |

ผังห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

ชั้น 10

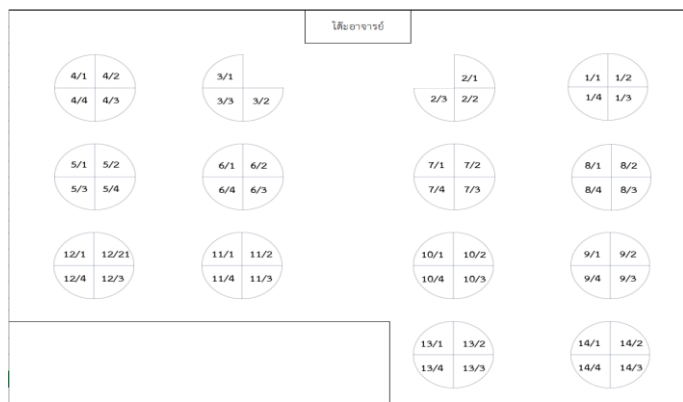

| โต๊ะที่ | SN/ เลขครุภัณฑ์ |                     | รายการที่เสีย               |
|---------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| 10/1    | SN:             |                     | เปลี่ยนชุดวาล์วควบคุม 3-way |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132280001979 สล./57 |                             |
| 10/2    | SN:             |                     | จอ TV ไม่ติด                |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132280001976 สล./57 |                             |
| 10/3    | SN:             |                     | จอ TV ไม่ติด                |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132280001977 สล./57 |                             |
| 10/4    | SN:             |                     |                             |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132280001978 สล./57 |                             |


| โต๊ะที่ | SN/ เลขครุภัณฑ์ |                     | รายการที่เสีย            |
|---------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| 11/1    | SN:             |                     | คอมไฟเสีย                |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132280001983 สล./57 |                          |
| 11/2    | SN:             |                     | คอมไฟเสีย + จอ TV ไม่ติด |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132280001980 สล./57 |                          |
| 11/3    | SN:             |                     | ขวดน้ำชำรุด              |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132280001981 สล./57 |                          |
| 11/4    | SN:             |                     | จอ TV ไม่ติด             |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132280001982 สล./57 |                          |

| โต๊ะที่ | SN/ เลขครุภัณฑ์ |                     | รายการที่เสีย                         |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|
| 12/1    | SN:             |                     | จอ TV ไม่ติด + ก้านโยกสวิตช์เท้าชำรุด |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132280001985 สล./57 |                                       |
| 12/2    | SN:             |                     | เปลี่ยนชุดวาล์วควบคุม 3-way           |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132280001984 สล./57 |                                       |
| 12/3    | SN:             |                     | ขวดน้ำชำรุด + ปลาย 3-way หาย          |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132280001987 สล./57 |                                       |
| 12/4    | SN:             |                     |                                       |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132280001986 สล./57 |                                       |

ผังห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

ชั้น 10

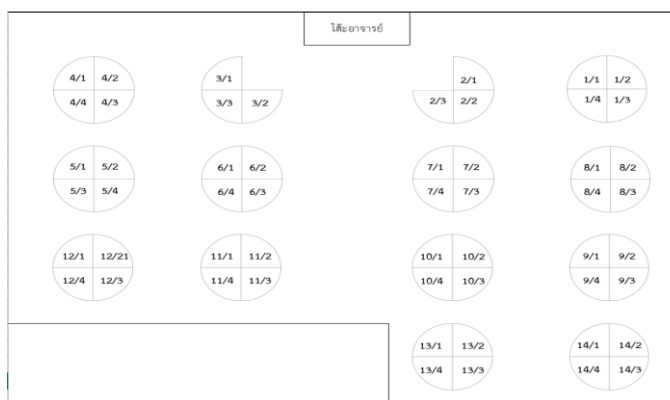

| โต๊ะที่ | SN/ เลขครุภัณฑ์ |                     | รายการที่เสีย                        |
|---------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|
| 13/1    | SN:             |                     | คอมพิวเตอร์เสีย                      |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132280001995 สล./57 |                                      |
| 13/2    | SN:             |                     | ก้านโยกสวิตซ์เท้าชำรุด               |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132280001992 สล./57 |                                      |
| 13/3    | SN:             |                     | จอ TV ไม่ติด-                        |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132280001993 สล./57 |                                      |
| 13/4    | SN:             |                     | จอ TV ไม่ติด+ ก้านโยกสวิตซ์เท้าชำรุด |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132280001994 สล./57 |                                      |

| โต๊ะที่ | SN/ เลขครุภัณฑ์ |                     | รายการที่เสีย |
|---------|-----------------|---------------------|---------------|
| 14/1    | SN:             |                     |               |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132280001988 สล./57 |               |
| 14/2    | SN:             |                     | จอ TV ไม่ติด- |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132280001991 สล./57 |               |
| 14/3    | SN:             |                     |               |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132280001990 สล./57 |               |
| 14/4    | SN:             |                     | จอ TV ไม่ติด- |
|         | เลขครุภัณฑ์:    | 132280001989 สล./57 |               |